

THƯ MỜI BÁO GIÁ

Gói thầu: “Mua máy xét nghiệm sinh hóa tự động cho TTYT Ngọc Lặc”

Kính gửi: Các đơn vị/nhà cung cấp.

Căn cứ Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023 của Quốc hội; Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quy hoạch, luật đầu tư, luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu; Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đấu thầu, luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, luật hải quan, luật thuế giá trị gia tăng, luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, luật đầu tư, luật đầu tư công, luật quản lý, sử dụng tài sản công

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Trung tâm y tế Ngọc Lặc có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo và lập dự toán gói thầu: “Mua máy xét nghiệm sinh hóa tự động cho TTYT Ngọc Lặc” với các nội dung sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm y tế Ngọc Lặc

Địa chỉ: Số 17 Thôn Lê Duẩn, xã Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa.

2. Thông tin liên hệ của cơ quan, người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

Phòng Hành chính – tổng hợp của Trung tâm y tế Ngọc Lặc

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: Nhận trực tiếp và qua email Phòng Hành chính – tổng hợp của Trung tâm y tế Ngọc Lặc.

Địa chỉ: Số 17 thôn Lê Duẩn, xã Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa.

Email: ttytngoclac2020@gmail.com.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày 02/04/2026 đến 17 giờ 00 phút ngày 13/04/2026.

Các báo giá nhận được sau thời gian trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 60 ngày kể từ ngày báo giá.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục hàng hóa cần thu thập báo giá tại Phụ lục 01.




2. Mẫu báo giá theo Phụ lục 02.

Rất mong nhận được sự quan tâm, hợp tác của các quý đơn vị/nhà cung cấp.

Nơi nhận: *ng*

- Như kính gửi;
- Lưu VT, HC

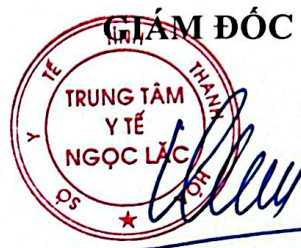

Hoàng Vĩnh Thắng



PHỤ LỤC 01: DANH MỤC HÀNG HÓA ĐỀ NGHỊ CUNG CẤP BẢO GIÁ
(Kèm theo hợp đồng số 45/TM-TTYT ngày 02 tháng 04 năm 2026 của Trung tâm Y tế Ngọc Lặc)

STT	Danh mục hàng hóa	Thông số kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
1	Máy xét nghiệm sinh hóa tự động	<p>1. Cấu hình: 01 máy chính + phụ kiện chuẩn đi kèm</p> <p>2. Thông số kỹ thuật</p> <ul style="list-style-type: none">- Công suất và loại phản ứng<ul style="list-style-type: none">+ Công suất ≥ 240 xét nghiệm/ giờ+ Nguyên lý xét nghiệm: Phương pháp đo màu, độ đục và ISE.+ Phương pháp đo: Điểm cuối, thời gian cố định, động học, ISE, thuốc thử phản ứng đơn/ đôi, một bước sóng (mono-chromatic) hoặc hai bước sóng (bi-chromatic).+ Chế độ sử dụng thuốc thử: Hỗ trợ xét nghiệm sử dụng một hoặc hai thuốc thử.+ Bước sóng: Hỗ trợ chế độ một hoặc hai bước sóng.- Hệ thống xử lý mẫu và thuốc thử<ul style="list-style-type: none">+ khay thuốc thử: ≥ 50 vị trí cho thuốc thử, ≥ 50 vị trí cho mẫu đặt trong ngăn lạnh của máy ($2\sim 12^{\circ}\text{C}$)+ Có hệ thống làm lạnh liên tục trong 24 giờ ở $2 - 12^{\circ}\text{C}$.+ Thể tích mẫu xét nghiệm sinh hóa: $2-35 \mu\text{L} \pm 0,1 \mu\text{L}$.+ Thể tích thuốc thử: R1: $100-200 \mu\text{L}, \pm 0,5 \mu\text{L}$; R2: $10-200 \mu\text{L}, \pm 0,5 \mu\text{L}$.+ Kim hút mẫu/thuốc thử: Phát hiện mức chất lỏng, chống va chạm chiều ngang và chiều dọc, kiểm tra lượng thuốc thử còn lại, làm ấm thuốc thử trước, tùy chọn thêm phát hiện tắc nghẽn+ Hệ thống rửa kim hút: Tự động phun nước rửa từ bên trong và bên ngoài.+ Tự động pha loãng mẫu: Pha loãng trước và pha loãng sau.	Máy	01

		<p>- Hệ thống phản ứng:</p> <p>+ Carousel: ≥ 80 vị trí cuvettes</p> <p>+ Nhiệt độ phản ứng: $37^{\circ}\text{C} \pm 0,1^{\circ}\text{C}$ (ủ không khí)</p> <p>+ Rửa cuvettes: Trạm rửa cuvette với hóa chất rửa được làm ấm trước và nước cất</p> <p>- Hệ thống đo quang:</p> <p>+ Nguồn sáng: Đèn halogen tungsten 12V/20W hoặc tương đương.</p> <p>+ Bước sóng ≥ 10 bước sóng (khoảng từ ≥ 340 nm)</p> <p>+ Dải đo hấp thụ: 0 - 3,5 A độ phân giải $\leq 0,0001$ Abs</p> <p>- Đơn vị vận hành:</p> <p>+ Hệ thống vận hành: Windows 10.</p> <p>+ Kết nối: RS-232 hoặc USB hoặc LAN.</p> <p>+ Có khả năng kết nối LIS/HIS 2 chiều.</p> <p>- Kiểm chuẩn và hiệu chuẩn:</p> <p>+ Chế độ hiệu chuẩn: Kfactor, tuyến tính (\geq hai điểm),</p> <p>+ Phi tuyến: logit-log, spline, polynomial hoặc tương đương</p> <p>+ Biểu đồ kiểm chuẩn: Westgard multi-rule, Levey-Jennings, Cumulative sumcheck, Twin plot hoặc tương đương.</p>		
--	--	---	--	--



PHỤ LỤC 2: MẪU BÁO GIÁ HÀNG HÓA

(Kèm theo thư mời số 4/CTM-TTYT ngày 02 tháng 04 năm 2026 của Trung tâm Y tế Ngọc Lặc)

Tên hãng sản xuất/nhà cung cấp:.....

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh:.....

Địa chỉ:.....

Số điện thoại:.....Mail:.....

BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: Trung Tâm Y tế Ngọc Lặc

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Trung tâm y tế Ngọc Lặc, Công ty/đơn vị xin gửi tới Quý Trung tâm bảng báo giá các mặt hàng như sau:

TT	Tên hàng hóa	Quy cách, Thông số kỹ thuật	Năm sản xuất	Xuất xứ	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá (VNĐ)	Thành tiền (VNĐ)
1								
2								
	Tổng cộng							

Số tiền bằng chữ:.....

* Ghi chú:

- Báo giá này có hiệu lực ngày kể từ ngày ký (Tối thiểu 60 ngày).
- Đơn giá trên đã bao gồm: thuế VAT, chi phí vận chuyển và các loại chi phí khác có liên quan
- Các điều khoản: Địa điểm giao hàng, Thời gian giao hàng, Phương thức thanh toán,....
- Chúng tôi cam kết:
 - + Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương tự khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo

quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- + Giá trị của các hàng hóa nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.
- + Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA CÔNG TY
Ký, ghi rõ họ và tên, đóng dấu